



Sinoimplant[®]
75 mg Levonorgestrel

TIPS PARA UN RETIRO EXITOSO

RECOMENDACIONES
PRÁCTICAS PARA LA
REMOCIÓN DE
SINOIMPLANT[®]

Material exclusivo para el cuerpo médico

RECUERDE

Una fácil extracción depende de una correcta inserción.

Si el implante se coloca correctamente, será más fácil retirarlo; si se coloca demasiado profundo, pueden presentarse problemas.¹ Las extracciones deben demorar solamente un poco más que las inserciones.¹

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA DURANTE EL PROCESO DE RETIRO?^{1,2}



- Palpar para localizar los implantes y marcar bien las posiciones.



- Utilizar prácticas de prevención de infecciones.



- Inyectar pequeñas cantidades de anestésico local (no > 1 ml en total) bajo los extremos más cercanos al sitio de la incisión original.



- Solo debería ser necesaria una incisión no > 4 mm para retirar ambas varillas.



- Retirar primero la barra que está más cerca del punto de incisión o más cerca de la superficie.



- Agregar cantidades incrementales de anestésico, solo bajo las barras.



- Controlar el sangrado aplicando presión.
- Trabajar con cuidado y paciencia para evitar lesiones.

- Si se desea, se pueden insertar nuevos implantes a través de la misma incisión (en la misma dirección o en la dirección opuesta).
- Recordar que inmediatamente tras el retiro de los implantes, se pierde el efecto anticonceptivo.



RECOMENDACIONES PARA LA USUARIA:

- Mantener el área seca y limpia por 48 horas
- Dejar los vendajes por 48 horas y la cinta quirúrgica hasta la curación (5 días)
- Puede haber signos de irritación
- Se puede retornar inmediatamente a las actividades, evitando el contacto con la herida
- Si se presentan signos de inflamación, consultar

IMPLANTES DIFÍCILES DE PALPAR:¹



- Utilizar rayos X usando un objeto radio-opaco para marcar el sitio de inserción



- Para determinar la profundidad, utilizar ultrasonido



- Puede requerirse posicionamiento especial de la sonda para la localización

IMPLANTES DIFÍCILES DE REMOVER:^{1,2}



- Detener el procedimiento (si > 30 minutos)



- Programar una segunda visita tras la cicatrización del área (4 a 6 semanas)



- Proporcionar un método anticonceptivo de respaldo, si se extrajo una de las dos varillas

Referencias:

1. Jhpiego Corporation. Providing Contraceptive Implants: Interim Version - Updated to Reflect 2015 World Health Organization Medical Eligibility Criteria. Published 2015. http://resources.jhpiego.org/system/files/resources/Providing_Contraceptive_Implants_Ref_Man_2015.pdf


2. World Health Organization (WHO). Shanghai Dahua Pharmaceutical. Sino-Implant (II) Summary of Product Characteristics, 2019. Accessed June 22, 2022. https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/RH028part4_0.pdf

Sinoimplant[®]

75 mg Levonorgestrel

SUPERANDO DESAFÍOS PARA ASEGURAR EL FUTURO

- Eficacia del 99,8%, por los 4 años, independiente del peso.¹
- Buen perfil de seguridad y aceptabilidad.²

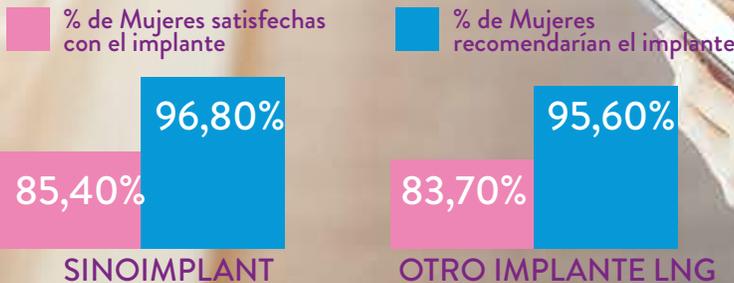

Perfiles de aceptabilidad basados en un estudio en población Latinoamericana
*LNG LEVONORGESTREL



Para mayor información lea este QR >>

TROCAR DESECHABLE Y MÁS DELGADO. AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

SINOIMPLANT[®]: 2 implantes de Levonorgestrel 75 mg. Forma farmacéutica: implantes. Vida útil: 4 años. Indicaciones: indicado para mujeres en edad fértil que deseen utilizar anticoncepción a largo plazo. Vía administración: Subcutánea. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al Levonorgestrel o a cualquier otro componente de la formulación. Certeza o sospecha de embarazo. Presencia o antecedentes de enfermedad hepática severa mientras los valores de la función hepática no hayan regresado a la normalidad. El implante anticonceptivo está contraindicado para aquellas mujeres que estén en período de lactancia durante las primeras seis semanas posparto (Criterios Médicos de Elegibilidad para uso Anticonceptivo, Organización Mundial de la Salud (OMS), actualizado en 2010). Diagnóstico o sospecha de tumores malignos dependientes de hormonas sexuales (por ejemplo, cáncer de mama). Sangrado vaginal no diagnosticado, tromboflebitis o trastorno tromboembólico arterial. Precauciones: El implante debe ser retirado a final de los 4 años de uso, porque se vuelve menos efectivo, especialmente en las mujeres que pesan más de 60 kg. Puede ser retirado en cualquier momento dentro del período de los 4 años si una mujer quiere dejar de usarlo por cualquier razón. Las usuarias de Sinoimplant deben visitar regularmente a su médico para realizar visitas de seguimiento. Las mujeres que se embarazan durante el uso de Sinoimplant deberán consultar con un médico para retirar sus implantes y llevar el embarazo a término. La concentración sérica de levonorgestrel es menor al final del uso de los implantes y esta inversamente relacionada con el peso corporal. Se debe tener cuidado de no causar daño a las varillas del implante durante su uso. Advertencias: La paciente debe consultar a un médico si tiene efectos secundarios intolerables debidos Sinoimplant[®]. Las mujeres a quienes les han retirado sus implantes y quienes no usan otra forma de anticoncepción pueden esperar que la fertilidad regrese prontamente (criterios médicos de elegibilidad para uso anticonceptivo, OMS, actualizado en 2008). No use los implantes si tiene, o se sospecha que tiene, cáncer de mama. Si tiene nódulos benignos en la mama, un mastopata o un mamograma anormal, o si tiene marcados antecedentes familiares de cáncer de mama, su médico debe hacer un seguimiento cuidadoso de su afección. La implantación, seguimiento y retiro del Sinoimplant[®] deben llevarse a cabo en un entorno de planificación familiar y deben ser realizados por profesionales calificados quienes han recibido entrenamiento especializado en el proceso. Raramente, ocurren embarazos ectópicos con los implantes con Levonorgestrel, si una mujer que usa implantes de Levonorgestrel se presenta con dolor en la parte inferior del abdomen o se determina que está embarazada, debe ser examinada para descartar un embarazo ectópico. Se han conocido informes de coágulos sanguíneos, infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares en relación con el uso de implantes con Levonorgestrel. Si bien los estudios no han demostrado un aumento considerable en la presión arterial en usuarias de implantes con Levonorgestrel, la presión arterial puede aumentar de todas formas, por lo tanto, debe controlarse en forma regular mientras está usando los implantes y si aumenta en forma sistemática, o de manera consistente y no puede ser controlada adecuadamente con un medicamento, deberían extraerse los implantes. Se ha informado tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la insulina alteradas en las pruebas orales de tolerancia a la glucosa en usuarias de implantes con Levonorgestrel en algunos estudios. Aumento de peso. Tener presente la posible alteración en lipoproteínas. Folículos ováricos agrandados pueden darse en mujeres con implantes con Levonorgestrel. Los folículos se detectan durante un examen físico y, por lo general, desaparecen solos. En raras ocasiones, pueden presentar torsión lo que provoca dolor abdominal y puede requerir cirugía. Los implantes de Levonorgestrel afectan el patrón de sangrado menstrual en la mayoría de las mujeres. No se debe confiar en la falta de periodos menstruales como único medio para diagnosticar un embarazo, se debe realizar una prueba de embarazo cada vez que se sospeche uno. Las mujeres con antecedentes de depresión deben ser controladas minuciosamente, y se debe considerar la extracción del implante si se desarrollan síntomas claros. Es habitual que ocurra un aumento transitorio leve o moderado de la bilirrubina total sérica al inicio del uso de los implantes, con un ligero aumento del riesgo de colicistitis durante el uso de otros implantes con Levonorgestrel de tipo similar. Los implantes con Levonorgestrel no protegen contra la infección por el VIH (Sida) u otras enfermedades de transmisión sexual. Si se produce un embarazo durante el tratamiento con Sinoimplant[®] se deberá extraer los implantes. Levonorgestrel pasa a la leche materna, pero en una cantidad que no parece afectar al niño; los niveles de Levonorgestrel que se obtienen con Sinoimplant[®] no afectan la calidad o la cantidad de leche materna. Aumento de la presión arterial del cerebro (presión intracraneal idiosincrásica): rara vez se han informado un aumento de la presión alrededor del cerebro en usuarias de implantes con levonorgestrel. Debe comunicarse con su médico si experimenta eefales frecuentes, severas o persistentes, o tiene problemas de la visión. Mujeres mayores de 45 años no deben usar Sinoimplant[®]. Efectos adversos: náuseas. Fatiga, dolor en la espalda y dolor en general. Pérdida/ganancia de peso. Malestar abdominal. Cambios de humor, disminución de la libido, depresión. Dolor o picazón del lugar del implante. Inflamación del cuello uterino. Quistes ováricos. Infección de las vías urinarias. Quistes de mama benignos, secreción de la mama. Una mujer que siente acné o vellosidad en exceso en su rostro o cuerpo puede experimentar un empeoramiento de estos problemas: pérdida de cabello, erupción cutánea, picazón o decoloración de la piel. Raras: Presión arterial elevada, palpitaciones, dolor de pecho, Venas varicosas. Dificultad para respirar, Migraña, expulsión del implante, si sucede sustituirlo; ampollas, úlceras, escoriaciones, desplazamiento del implante con dolor y molestia asociados. Registro INVIMA 2017M-0017722. Condición de almacenamiento: almacenar a temperatura inferior de 30°c en su envase y empaque original. TROCARES DESECHABLES PARA MEDICAMENTOS – TROCAR PARA IMPLANTE ANTI-CONCEPTIVO. Tipo de dispositivo: Invasivo. Composición: El trocar desechable utilizado para la inserción del implante anticonceptivo, está hecho de dos materiales: Acero inoxidable y polietileno butadieno estireno o ABS. Vida útil: 5 años. Registro TROCAR INVIMA 2017DM-00015824. Registro INVIMA AGUJA HIPODÉRMICA 2019DM-0020484. Registro INVIMA JERINGA DESECHABLE 2019DM-00083832. Registro INVIMA GASA PRE-CORTADA ESTÉRIL 2019DM-0007919. Registro INVIMA VENDA ELÁSTICA 2019DM-0005207-01 y 2019DM-00073343. Referencias: 1. Sino-implant (I) Brochure. Shanghai Dahan Pharmaceutical. Accessed May 18, 2022. https://www.hi360.org/sites/default/files/media/documents/sino-implant_brochure_Spanish_V4.pdf. 2. Steiner MJ, Brache V, Taylor DA, et al. Randomized trial to evaluate contraceptive efficacy, safety and acceptability of a two-rod contraceptive implant over 4 years in the Dominican Republic. *Contracept X*. 2019;1:100006.



COL2333809

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL CUERPO MÉDICO